
Ficha técnica de material
Paños quirúrgicos OPS™ Essential con refuerzo de material

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material principal
Polipropileno spunbond/
Película de polietileno

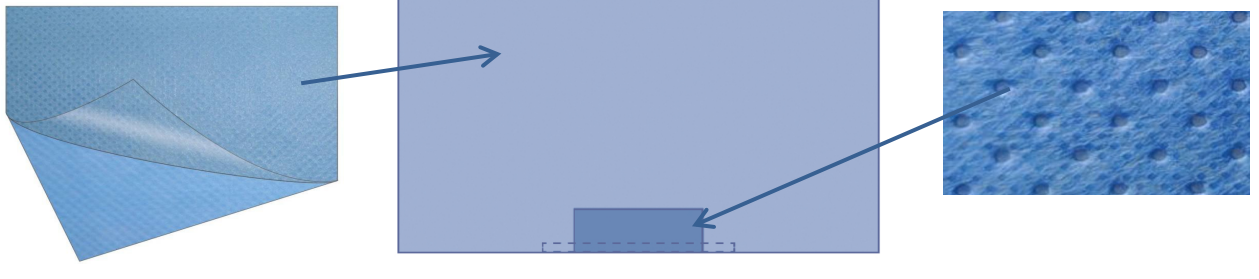

Refuerzo
Polipropileno spunbond

Libre de látex

HP
EN13795-1

		Requisitos EN 13795-1			
		Alto rendimiento			
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Área de productos críticos**	**Área de productos menos críticos**	**Combinación**	**Tejido principal únicamente**
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**24***	**11***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	6,0	No requerido	**6,0****	**6,0****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****	**N/A - Estéril*****
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**1,57***	**1,68***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 100	≥ 10	**118***	**165***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**284,5***	**113,7***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**286,4***	**114,7***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**200,8***	**51,5***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**121,7***	**82,9***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**220,8***	**53,8***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**136,6***	**82,1***

	Datos adicionales		
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**121****	**58****
Capacidad de absorción (%)	EN ISO 9073-6	**> 650****	**> 250****
Capacidad de absorción (ml/m²)	Conversión	**> 700****	**> 145****
Láser - Ignición primaria	EN 11810	**N/A**	**Clase I1_95**
Láser - Penetración	EN 11810	**N/A**	**Clase P4_21**
Composición del material	N/A	**N/A**	**N/A**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_EssentialDrapeReinforcement_ES05