
Hoja de datos del material

• 3 batas quirúrgicas Eclipse; XL

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant
Francia:
www.medline.com/es/

Material
Poliéster y pasta de celulosa

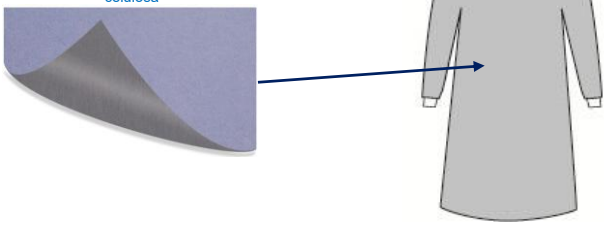

LATEX
Libre de látex

SP
EN13795-1

		Requisitos de EN 13795-1		
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Prestación Estándar**		**Tejido principal únicamente***
		Área crítica de producto	**Área de producto menos crítica**	
Resistencia a la penetración microbiana - Seco (CFU)	EN ISO 22612	No se requiere	<=300	**23**
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (IB)	EN ISO 22610	>= 2,8	No se requiere	**3,6**
Limpieza - Microbiana (CFU/100cm²)	EN ISO 11737-1	<= 300	<= 300	**N/A - Estéril*** **
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	<= 4,0	<= 4,0	**3,65**
Resistencia a la penetración de líquidos (cmH2O)	ISO 811	>= 20	>= 10	**23**
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	>= 40	>= 40	**262,5**
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	>= 40	No se requiere	**271**
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	>= 20	>= 20	**9**
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	>= 20	>= 20	**136**
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	>= 20	No se requiere	**65,4**
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	>= 20	No se requiere	**147**

	Datos adicionales:	
Gramaje (g/m2)	EN 29073-1	**62**
Repelencia al alcohol - Solución IPA (grado)	IST 80,8	**7**
Composición:	N/A	**-Poliéster y pasta de celulosa spunlace**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. MDS_EclipseGowns_ES02