
Ficha técnica de material

Paños quirúrgicos OPS™ Eclipse

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material principal
Poliéster/pulpa de celulosa

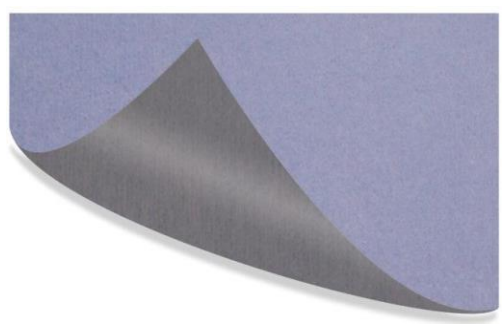

Libre de látex

SP EN13795-1

Característica EN 13795-1	Método de ensayo	Requisitos EN 13795-1 Prestación Estándar Área crítica	Prestación Estándar Área menos crítica	Tejido principal únicamente
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**40****
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	≥ 2,8	No requerido	**2,86****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**3,66****
Resistencia a la penetración de líquidos (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 30	≥ 10	**24,3****
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**324,1****
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**358,5****
Resistencia a la tracción - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 15	≥ 15	**130,6****
Resistencia a la tracción - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 15	≥ 15	**155,8****
Resistencia a la tracción - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 15	No requerido	**126,2****
Resistencia a la tracción - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 15	No requerido	**140,8****

	Datos adicionales	
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**68****
Repelencia al alcohol - Solución IPA (grado)	EN ISO 9073-6	**7****
Composición del material	N/A	**-Poliéster y pasta de celulosa spunlace**

* Los datos técnicos se basan en el promedio
** Los datos técnicos se basan en la media
*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_EclipseSurgicalDrape_ES02