
Hoja de datos del material
OPS™ Eclipse Paño quirúrgico con refuerzo

Medline International France SAS
5, calle Charles Lindbergh
44110 Chateaubriant
Francia:
www.medline.com/es/

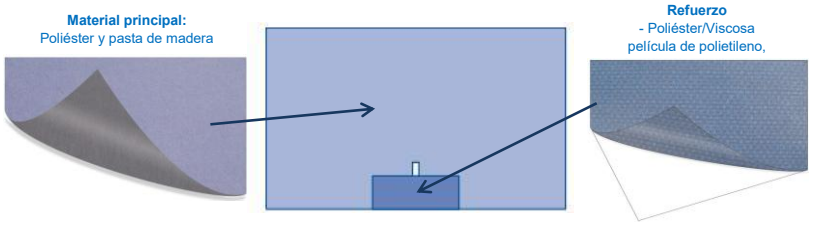

LATEX
Libre de látex

HP
EN13795-1

		Requisitos de la norma EN 13795-1			
		Alto rendimiento			
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Área crítica de producto**	**Área de producto menos crítica**	**Combinación**	**Tejido principal únicamente***
Resistencia a la penetración microbiana - Seco (CFU)	EN ISO 22612	No se requiere	≤300	**No se requiere**	**23**
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (IB)	EN ISO 22610	6,0	No se requiere	**6,0**	**3,6**
Limpieza - Microbiana (CFU/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*** **	**N/A - Estéril*** **
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**3,45**	**3,65**
Resistencia a la penetración de líquidos (cmH2O)	ISO 811	≥ 100	≥ 10	**≥ 200***	**23**
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**471,5**	**262,5**
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No se requiere	**350,5**	**271**
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	ES 29073-3	≥ 20	≥ 20	**75,7**	**9**
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	ES 29073-3	≥ 20	≥ 20	**255**	**136**
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	ES 29073-3	≥ 20	No se requiere	**71,4**	**65,4**
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	ES 29073-3	≥ 20	No se requiere	**213**	**147**

	Datos adicionales:		
Gramaje (g/m2)	ES 29073-1	**135**	**62**
Repelencia al alcohol - Solución IPA (grado)	IST 80,8	**N/A**	**7**
Composición:	N/A	**- No tejido de poliéster y viscosa película de polietileno, - Poliéster y pasta de madera**	**-Poliéster y pasta de celulosa spunlace**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. MDS_Cubre eclipsado con refuerzo_EN03