
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es

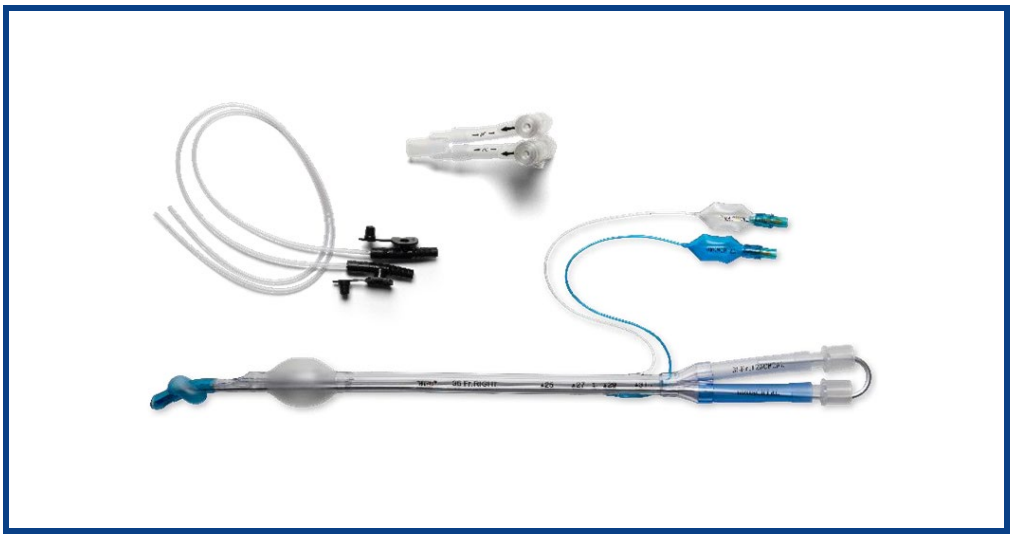

Ficha técnica

ENDOSID®

Tubo bronquial de doble lumen, estéril

Referencia(s)

REF	Cantidad por caja	Cantidad por envase	Talla CH	Punta del tubo de alineación	Catéter de aspiración en CH	Diámetro interno (mm)	Longitud del tubo en mm
847028-LZ	1	10	28	Lado izquierdo	6	3,2	330
847032-LZ	1	10	32	Lado izquierdo	8	3,8	330
847035-LZ	1	10	35	Lado izquierdo	10	4,0	330
847037-LZ	1	10	37	Lado izquierdo	10	4,4	330
847039-LZ	1	10	39	Lado izquierdo	10	4,6	330
847041-LZ	1	10	41	Lado izquierdo	12	6,0	330
847028-RZ	1	10	28	Lado derecho	6	3,2	330
847032-RZ	1	10	32	Lado derecho	8	3,8	330
847035-RZ	1	10	35	Lado derecho	10	4,0	330
847037-RZ	1	10	37	Lado derecho	10	4,4	330
847039-RZ	1	10	39	Lado derecho	10	4,6	330
847041-RZ	1	10	41	Lado derecho	12	6,0	330

Descripción

Tubo bronquial de doble lumen para la ventilación y aspiración lateral de los pulmones durante la ventilación unipulmonar. La tráquea puede cerrarse con un manguito transparente que se corresponde con el globo de control transparente, el bronquio puede cerrarse con un manguito azul que se corresponde con el globo de control azul.
Los conectores de codo bloqueables manualmente permiten apagar o añadir la ventilación del segmento pulmonar aislado. En el set se incluyen dos catéteres de aspiración como accesorios para aspirar las secreciones de los pulmones.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_8470xx-LZ-RZ ENDOSID Bronchial-Doppellumen-Tubus_ES01

0123 Libre de látex

DEHP

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 8

Conector universal en la parte superior para conectar a un ventilador.

No debe utilizarse:

- en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados
- En pacientes con edema laríngeo, inflamación, hemorragia o traumatismo cervical.
- No apto para su uso en IRM

Vida útil de 5 años
Almacenamiento +15°C a +49°C, en lugar seco, protegido de la luz solar
Producto de un solo uso, no reutilizable
No reprocesable
Conector universal 15 mm
Franja de contraste de rayos X consistente
Balón piloto traqueal transparente con válvula para jeringas Luer y Luer-Lock
Balón piloto bronquial azul con válvula para jeringas Luer y Luer-Lock
Longitud graduación

Materiales principales

Parte del producto	Material
Tubo	Policloruro de vinilo (PVC)
Manguito traqueal	Policloruro de vinilo (PVC)
Manguito bronquial	Policloruro de vinilo (PVC)
Conectores universal	PP, ABS
Balón de inflado traqueal	Policloruro de vinilo (PVC)
Balón de inflado traqueal	Policloruro de vinilo (PVC)
Balón de inflado de válvula	RPVC, PP, ABS, acero inoxidable
Raya de contraste de rayos X	Sulfato de bario (BaSo 4)
Estilete	Aluminio, teflón

- Libre de látex
- Contiene PHT (DEHP)

Fabricante legal

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou,
REPÚBLICA POPULAR CHINA
De acuerdo con la norma ISO13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase IIa estéril

•Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

0123 Libre de látex

DEHP

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 8