
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja, Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid, España
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

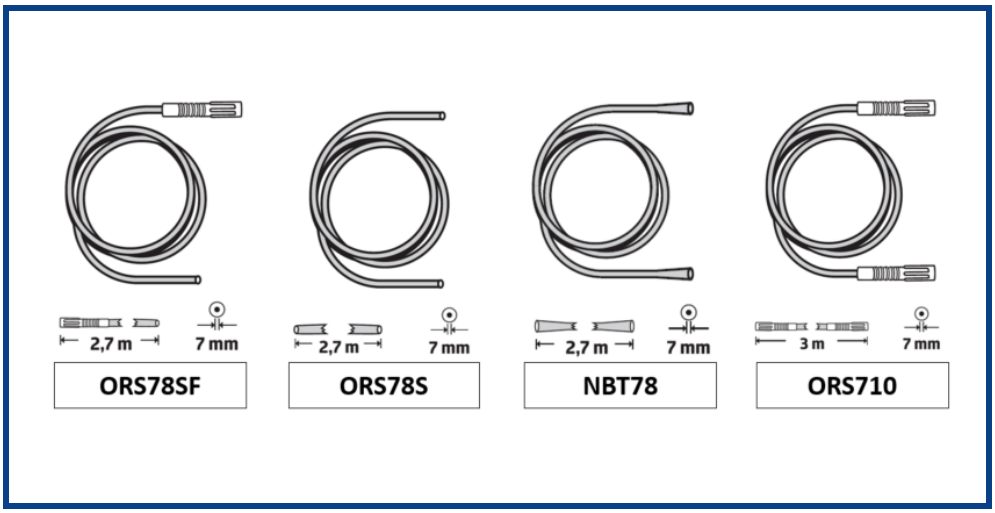

Ficha técnica

Tubo de aspiración superblando estéril
sin ftalatos

Referencias

ORS78SF; ORS78S; NBT78; ORS710

Descripción

Tubo de aspiración superblando estéril transparente sin DEHP.

Referencia	Largo (m)	Diámetro interno (mm)	Conector	Cantidad por caja
ORS78SF	2,70	7 mm	De embudo/recto	30
ORS78S	2,70	7 mm	Recto	30
NBT78	2,70	7 mm	Con extremos de bulbo	30
ORS710	3,00	7 mm	De embudo/ De embudo	30

Materiales principales

PVC
Libre de DEHP, libre de látex

Cantidad por caja

30 unidades por caja

Esterilización

Esterilizado con óxido de etileno

Envasado

Envasado doble

Fabricante legal

GC MEDICA ENTREPRISE LTD - ISO 13485
Distribuido por Medline International France SAS

Normativa

De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase: IIa estéril

CE 0197 STERILE EO

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_SUCTION_TUBING_FREE_ES01