
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:

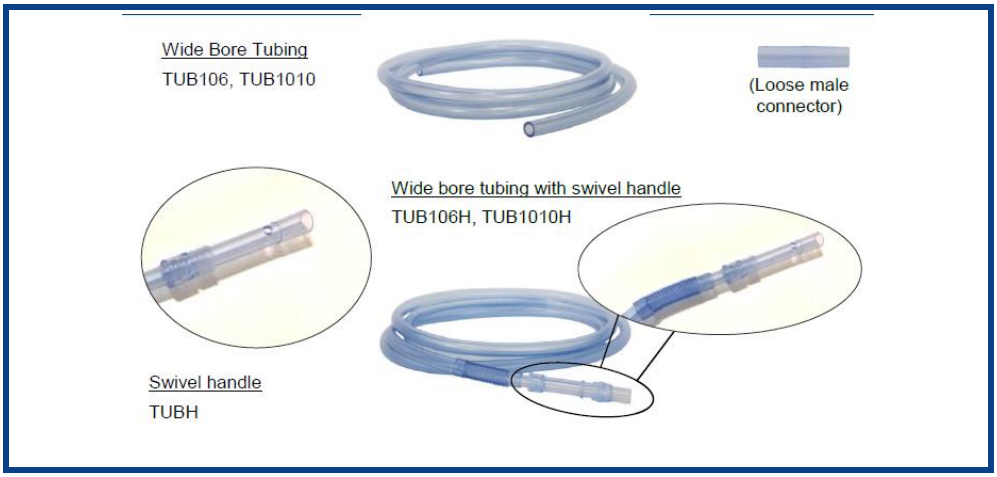

Ficha técnica

Tubo de succión de diámetro ancho

con o sin mango giratorio

Referencia(s)

Referencia	Diámetro interno	Longitud	Mango giratorio con control de vacío	Conector macho suelto
TUBH	Mango giratorio			
TUB106	11.5 mm	2.00 m	NO	NO
TUB1010	11.5 mm	3.00 m	NO	NO
TUB106H	11.5 mm	2.00 m	SÍ	SÍ
TUB1010H	11.5 mm	3.00 m	SÍ	SÍ

Descripción

El tubo de succión de calibre ancho Medline (TUB106, TUB1010) es un tubo de diámetro interior de 11,5 mm, lo suficientemente grueso para evitar el colapso bajo alta presión de vacío, pero flexible y fácil de usar. El tubo transparente presenta un orificio grande para maximizar el flujo de volumen o drenaje con facilidad de visualización.

El mango giratorio (TUBH) tiene una rotación de 360° para garantizar la comodidad y conveniencia del cirujano. Incorpora un aro con muescas que se desliza fácilmente por las aberturas de aspiración para controlar cómodamente el proceso. El mango giratorio Medline es compatible con las curetas Medline y se adapta a los diseños de curetas más comunes. (Aspiración uterina y ginecológica)

El tubo de succión de calibre ancho Medline con mango giratorio (TUB106H, TUB1010H) viene con el mango giratorio preconectado a un tubo de plástico flexible y resistente al colapso de 11,5 mm de diámetro interior.
Cada bolsa también contiene un conector macho suelto para la conexión a máquinas de succión cuando sea necesario.

Materiales principales

Mango giratorio y conector macho suelto: Resina K
Tubo: Sin PVC ni DEHP
Libre de látex

Cantidad por caja

10 productos por caja

Envasado

Bolsa individual con doble envoltorio

Fabricante legal

Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios y el MDR del Reino Unido

soporte

CE 2797 LATEX Libre de látex STERILE EO UK CA 0086

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

	Clase: Es estéril
Otra información	Esterilizado con óxido de etileno

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

2797 Libre de látex 0086