
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

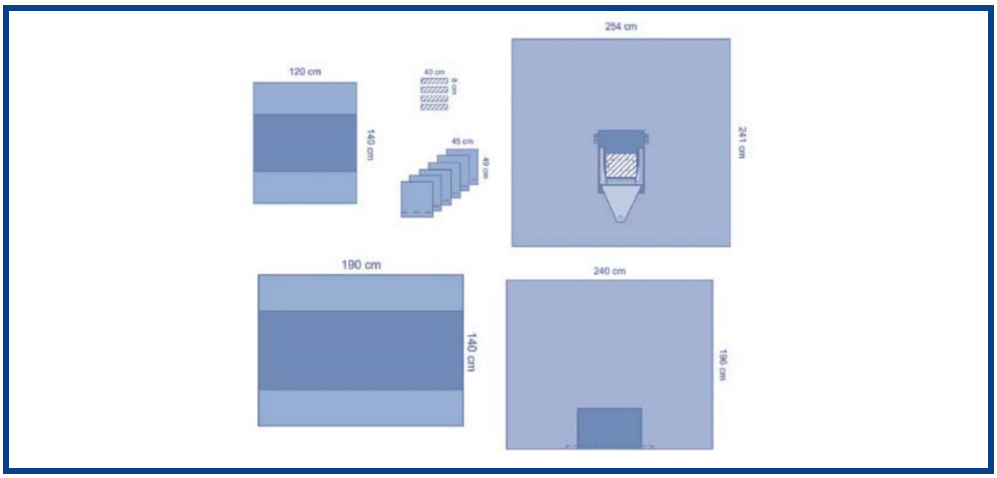

Ficha técnica

ECLIPSE

Equipo para craneotomía

Referencia(s)	**CP29008CE**
Descripción	Un envoltorio SMS contiene: - Un cubremesa de 140x190 cm, 50 µm* contiene: - 1 cubremesas de 140x120 cm, 50 µm, plegada*. - 1 paño de spunlace, 240x196cm, refuerzo 47x74cm, adhesivo*** - 6 paños trilaminadas, 45x49cm, adhesivas*. - 1 paño neurológico de spunlace, 254x241 cm, fenestración de 28x18 cm con película incisa, refuerzo de 49,5x72 cm, bolsa neurológica, 2 lengüetas de sujeción del cordón**. - 4 cintas adhesivas transparentes, 8x40 cm
Materiales principales	Eclipse® spunlace (poliéster + celulosa) - Refuerzo absorbente de polirayón (poliéster + viscosa) Material trilaminado absorbente e impermeable (polietileno + polipropileno)
Cantidad por caja	4 unidades por caja de cartón
Envasado	Bolsa de esterilización Una bolsa contiene todas las unidades en una caja de cartón
Fabricante legal	Medline International France SAS En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios Clase MD: I - estéril *HP según EN13795-1 **SP según EN13795-1 ***Alta prestación según la norma EN13795-1 en zonas reforzadas Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otra información	NA

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.
TDS_NeuroPack_CP29008CE_ES02

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Libre de látex