
Ficha técnica de material

Gama de pijamas quirúrgicos Ultimate (Gama P45x)

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
www.medline.eu/es

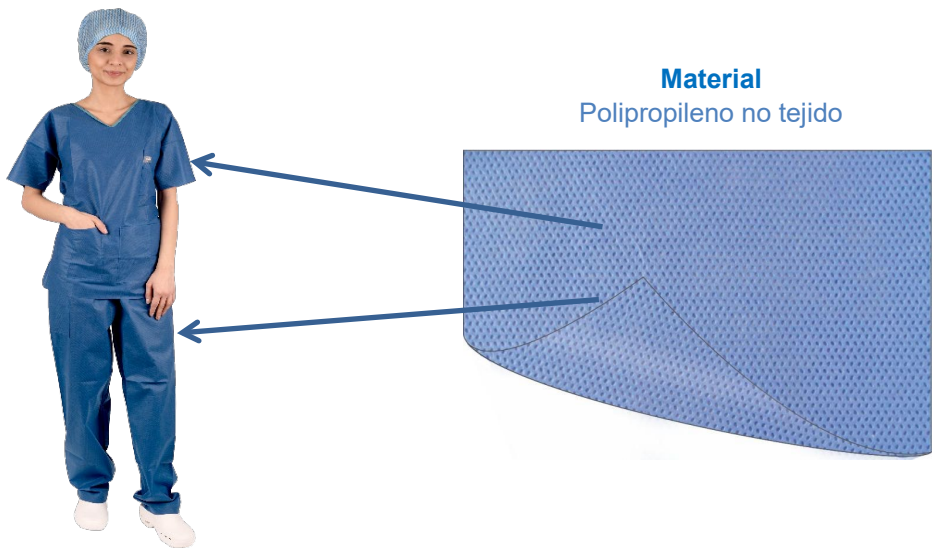

Material
Polipropileno no tejido

Libre de látex

Característica	Método de ensayo	Rendimiento	Tejido principal*
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	≤ 100	**6,0**
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 100	**1,0**
Limpieza - Particulado	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	**2,03**
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	**101,2**
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	**70,1**
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	**43,0**

	Datos adicionales	
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**45**
Composición del material	N/A	**- Polipropileno no tejido**

* Los datos técnicos se basan en el cuartil

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_UltimateScrubSuitsRanges_P45x_Range_ES01