
Medline International Iberia S.L.U
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Edificio 6, Planta 3, Lote A
Calle de Campezo 1
28022 Madrid
Spain
Tel: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



DYNDSCLW

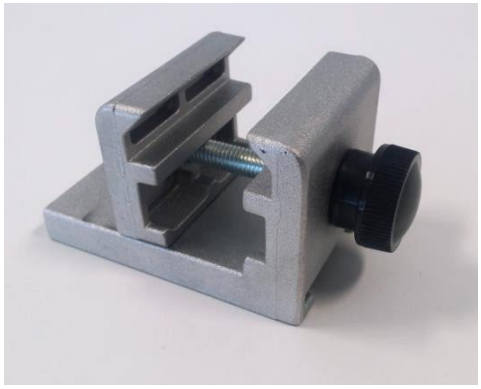

LCLC1426CE

Ficha técnica

SOPORTE DE PARED REUTILIZABLE
para sistemas de aspiración de Medline

Referencia(s)	**DYNDSCLW, LCLC1426CE**
Descripción	**DYNSCLW: Placa de pared de plástico con 3 orificios (tornillos no incluidos)** La placa de pared debe atornillarse a la pared con los 2 tornillos. A continuación, el soporte rojo del recipiente Medline (o el soporte en forma de anillo para MED-RIGID) puede deslizarse verticalmente en la placa de pared. Dimensiones: 5cm x 9,5cm x 1.5cm **LCLC1426CE: Garra de riel metálica** con ajuste de tornillo para riel estándar. Una vez fijado, el soporte rojo del recipiente Medline (o el soporte en forma de anillo para MED-RIGID) puede deslizarse verticalmente en la garra de riel metálico. Dimensiones: 5,3cm x 10cm x 5,3cm Ambos soportes son compatibles con todos los recipientes de aspiración Medline: MED-SOFT, MED-RIGID, MED-SEMI RIGID y Flex-One™. Ambos soportes se consideran productos de ferretería, son reutilizables y deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con los procedimientos hospitalarios.
Materiales principales	DYNDSCLW: PVC LCLC1426CE: Metal
Cantidad por caja/Envasado	DYNDSCLW: 20 unidades/caja LCLC1426CE: 1 unidad/caja
Fabricante legal	DYNDSCLW: Medline Industries, LP. Northfield, IL 60093 EE. UU. - EN ISO 13485 LCLC1426CE: PROSIMED SRL, Italia, de acuerdo con la norma EN ISO 13485.
Normativa	DYNDSCLW, LCLC1426CE: Clase I no estéril, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017-745 sobre productos sanitarios.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_WALL-HARDWARE_ES02

NON STERILE CE LATEX

Revisión: 8
Document Title: FINT.441 - Technical sheet
Document Number: EU1-00004-F-00025

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte