
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es

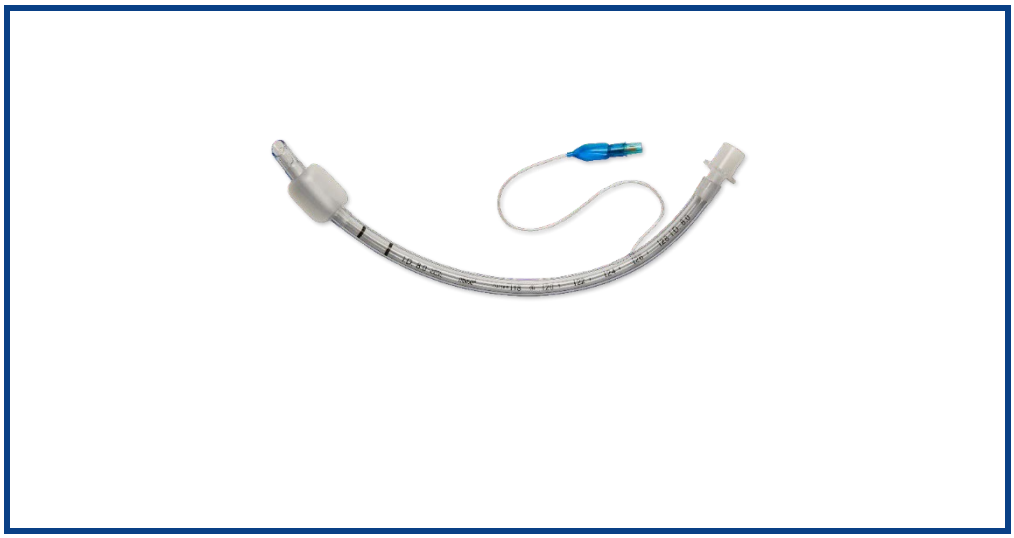

Ficha técnica

ENDOSID®

Tubo endotraqueal, estéril

Referencia(s)

Ref	Unidad Mínima de Venta (Estuche)	Cantidad por Caja	Ø Diámetro interior (mm)	Ø Diámetro exterior (Mm)	Longitud del tubo en mm
841030	10	100	3	4,2	165
841035	10	100	3,5	4,9	185
841040	10	100	4	5,5	210
841045	10	100	4,5	6,2	225
841050	10	100	5	6,9	245
841055	10	100	5,5	7,5	275
841060	10	100	6	8,2	285
841065	10	100	6,5	8,8	295
841070	10	100	7	9,6	310
841075	10	100	7,5	10,2	315
841080	10	100	8	10,9	330
841085	10	100	8,5	11,5	330
841090	10	100	9	12,1	330
841095	10	100	9,5	12,7	330
841100	10	100	10	13,6	330

Descripción

Tubo endotraqueal precurvado (Magill) con manguito y ojo de Murphy para asegurar la vía aérea en el campo de la anestesia y la medicina de urgencias en uso oral y nasal.
Conector universal en el extremo superior para conexión a un ventilador o bolsa de reanimación

No debe utilizarse:

- en pacientes sensibles a cualquiera de los materiales utilizados
- En combinación con lubricantes a base de aceite

No apto para uso en IRM

- Vida útil de 5 años
- Almacenamiento +15°C a +49°C, en lugar seco, protegido de la luz solar
- Producto de un solo uso, no reutilizable
- No reprocesable
- Conector universal 15 mm

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

0123 Libre de látex

DEHP

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 8

	• Franja de contraste de rayos X consistente • Franja de contraste de rayos X consistente • Doble anillo de marcado negro para controlar la profundidad de la intubación • Longitud graduación
Materiales principales	<table><tr><th>Parte del producto</th><th>Material</th></tr><tr><td>**Tubo**</td><td>Cloruro de polivinilo, transparente (PVC)</td></tr><tr><td>**Puño**</td><td>Policloruro de vinilo (PVC)</td></tr><tr><td>**Conector universal**</td><td>Polipropileno (PP)</td></tr><tr><td>**Globo de inflado**</td><td>Policloruro de vinilo (PVC)</td></tr><tr><td>**Balón de inflado de válvula**</td><td>RPVC, PP, ABS, acero inoxidable</td></tr><tr><td>**Raya de contraste de rayos X**</td><td>Sulfato de bario (BaSo4)</td></tr></table> • Libre de látex • Contiene PHT (DEHP)
Fabricante legal	Well Lead Medical Co., Ltd. C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, REPÚBLICA POPULAR CHINA De acuerdo con la norma ISO13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios Clase IIa- estéril •Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

0123 Libre de látex

DEHP

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte