
Medline International Iberia S.L.U
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Edificio 6, Planta 3, Lote A
Calle de Campezo 1
28022 Madrid
Spain

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

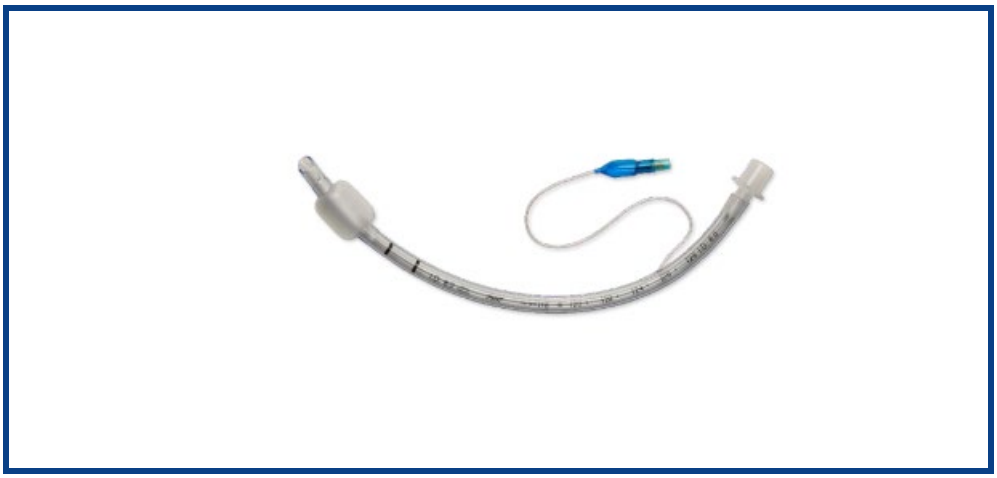

Ficha técnica

Endosid®

Tubo endotraqueal, estéril

Referencia(s)

Referencia	Cantidad por bolsa	Cantidad por caja	Ø Interior Diámetro (mm)	Ø Exterior Diámetro (mm)	Longitud del tubo en milímetros
841030A	10	100	3	4.2	165
841035A	10	100	3.5	4.9	185
841040A	10	100	4	5.5	210
841045A	10	100	4.5	6.2	225
841050A	10	100	5	6.9	245
841055A	10	100	5.5	7.5	275
841060A	10	100	6	8.2	285
841065A	10	100	6.5	8.8	295
841070A	10	100	7	9.6	310
841075A	10	100	7.5	10.2	315
841080A	10	100	8	10.9	330
841085A	10	100	8.5	11.5	330
841090A	10	100	9	12.1	330
841095A	10	100	9.5	12.7	330
841100A	10	100	10	13.6	330

Descripción

Tubo endotraqueal precurvado (Magill) con balón y orificio de Murphy para asegurar la vía aérea en el campo de
la anestesia y medicina de urgencias para uso oral y nasal.
Conector universal en el extremo superior para conexión a un ventilador o bolsa de reanimación

No debe utilizarse:
• En pacientes sensibles a cualquiera de los materiales utilizados
• En combinación con lubricantes a base de aceite

No apto para uso en IRM

• Vida útil de 5 años
• Almacenamiento: de +15°C a +49°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar
• Producto de un solo uso, no reutilizable
• No reprocesable
• Conector universal 15 mm
• Franja de contraste de rayos X consistente

CE 0123 LATEX Sin látex STERILE EO PHT sin DEHP

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

	• Globo piloto azul con válvula para jeringas Luer y Luer-Lock • Doble anillo de marcado negro para controlar la profundidad de la intubación • Graduación de longitud

Materiales principales

Parte del producto	Material
Tubo	Cloruro de polivinilo, transparente (PVC)
Puño	Policloruro de vinilo (PVC)
Conector universal	Polipropileno (PP)
Inflado - Globo	Policloruro de vinilo (PVC)
Balón de inflado de válvula	RPVC, PP, ABS, acero inoxidable
Raya de contraste de rayos X	Sulfato de bario (BaSo4)

Fabricante legal

Well Lead Medical Co., Ltd.
Polígono industrial C-4 Jinhu, Hualong
RELACIONES PÚBLICAS CHINA
De conformidad con la norma ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
Clase IIa estéril

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.