
Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

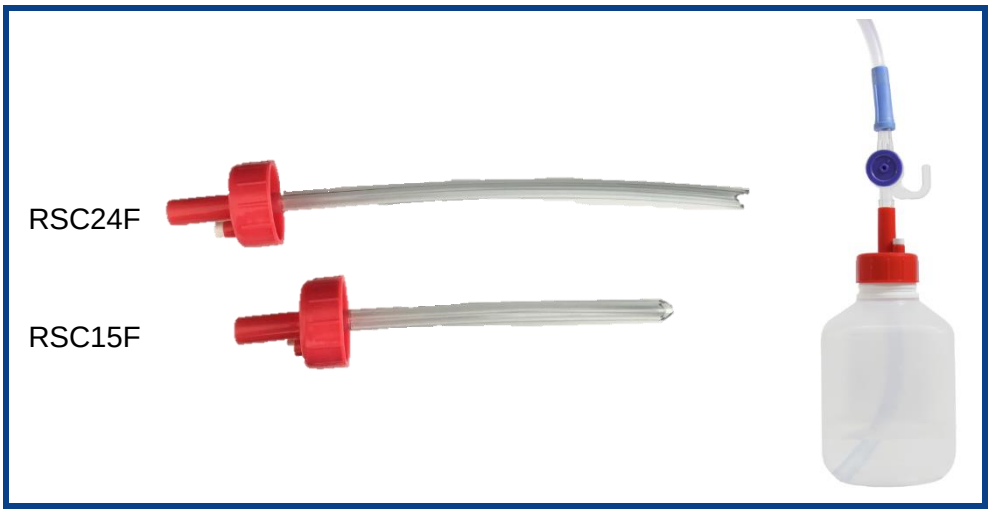

Ficha técnica

Tapón del sistema de lavado
Para circuito de aspiración

Referencia(s)	**RSC15F, RSC24F**
Descripción	El tapón del sistema de lavado es compatible con botellas de agua estéril. Se utiliza para descontaminar el conector med-stop entre dos aspirados traqueales del mismo paciente. El producto está construido en dos partes: - El tapón rojo es compatible con las botellas de Fresnius/Aguettant, Baxter y BBraun - Un tubo de inmersión disponible en dos longitudes: o RSC15F: 17 cm para una botella de 500 ml o RSC24F: 24 cm para una botella de 1 l
Materiales principales	PVC, polietileno de alta densidad Libre de látex y libre de DEHP
Cantidad por caja	100 unidades por caja
Envasado	Esterilización mediante óxido de etileno Envase individual
Fabricante	GC MEDICA ENTERPRISE LTD – ISO 13485 Distribuido por Medline International France SAS
Normativa	De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios Clase: I estéril

0197

STERILE EO

© 2018 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.